ANLEITUNG

OHRSTÜCKE FÜR WIDEX HDO-HÖRSYSTEME

Standard-Ohrstücke

WIDEX®

HIGH DEFINITION HEARING

INHALT

EINFÜHRUNG **3**
ÜBERSICHT **4**
STANDARD-OHRSTÜCKE **6**
Links/rechts-Kennung 7
Anlegen des Hörsystems 8
Abnehmen des Hörsystems 9
Pflege 10
AUSWECHSELN DES SCHALLSCHLAUCHS / DER HÖRERZULEITUNG UND DES OHRSTÜCKS. **16**
Montage des neuen bzw. gereinigten und getrockneten Ohrstücks 17
NANOCARE CERUMENSCHUTZ **19**
Wechsel des Cerumenschutzes 20
LOSES ANKERTEIL **23**
INTEGRIERTES ANKERTEIL **27**
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG **31**
Ohrstücke mit Hörerzuleitung 31
Ohrstücke mit Schallschlauch 32
WARNHINWEISE **33**
AUFBEWAHRUNG UND ALLGEMEINE HANDHABUNG **34**

EINFÜHRUNG

Diese Anleitung gibt einen Überblick über verschiedene Standard-Ohrstück-Lösungen für Widex® HdO-Hörsysteme (Hinter-dem-Ohr). Handelt es sich bei Ihrem HdO-Hörsystem um ein RIC-Hörsystem, wird das Signal vom Hörgerät hinter dem Ohr über eine Hörerzuleitung, an deren Ende der Hörer, d. h. der Lautsprecher, angebracht ist, und ein Ohrstück ins Ohr geleitet. Handelt es sich bei Ihrem Hörsystem um ein Dünnschlauch-Hörsystem, wird das Signal vom Hörgerät hinter dem Ohr über einen Winkeladapter, einen dünnen Schallschlauch und ein Ohrstück ins Ohr geleitet. Abhängig vom Hörsystem-Modell stehen bestimmte Ohrstücke zur Auswahl.

WARNUNG

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen und Anweisungen zu Ihrer Ohrstück-Lösung und ergänzt die Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems. Bitte lesen Sie sowohl die Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems als auch die Abschnitte in dieser Anleitung, die sich auf Ihre Ohrstück-Lösung beziehen, aufmerksam durch, ehe Sie Ihr Hörsystem in Betrieb nehmen.

BITTE BEACHTEN:
Hörsysteme, Bestandteile, Reinigungswerkzeuge etc. können in dieser Anleitung anders aussehen als Ihr Hörsystem mit Zubehör. Änderungen vorbehalten.

ÜBERSICHT

Bitten Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker, auf diesen Seiten anzukreuzen, welche Ohrstück-Lösung für Ihr Hörsystem gewählt wurde.

Standard-Ohrstücke

Standard-Ohrstück & RIC-Hörerzuleitung	
❑	Hörer-Schirmchen, für RIC-S/M
❑	Hörer-Tulpe, für RIC-S/M/P
❑	Hörer-Doppeldome, für RIC-S/M/P

Folgende Abschnitte lesen	**Seite**
Einführung	3
Übersicht	4-5
Standard-Ohrstücke	6-18
NanoCare Cerumenschutz	19-22
Ankerteil	23-26
Fehlersuche und -behebung	31
Warnhinweise	33
Aufbewahrung und allgemeine Handhabung	34-35

Hörsystem-Modell: _____

Hörerzuleitungslänge: Links _____ Rechts _____

Ohrstückgröße: Links _____ Rechts _____

Standard-Ohrstück & Dünnschlauch	
❑	Schirmchen, für Dünnschlauch
❑	Tulpe, für Dünnschlauch
❑	Doppeldome, für Dünnschlauch

Folgende Abschnitte lesen	Seite
Einführung	3
Übersicht	4-5
Standard-Ohrstücke	6-17
Ankerteil	23-30
Fehlersuche und -behebung	32
Warnhinweise	33
Aufbewahrung und allgemeine Handhabung	34-35

Hörsystem-Modell: _____

Schallschlauchlänge: Links _____ Rechts _____

Ohrstückgröße: Links _____ Rechts _____

STANDARD-OHRSTÜCKE

Die Standard-Ohrstücke werden – abhängig vom Hörsystem-Modell – mit einer **RIC-Hörerzuleitung** oder einem **Dünnschlauch** verwendet. Bei der RIC-Lösung sitzt der Hörer (Lautsprecher des Hörsystems) am Ende der Hörerzuleitung im Ohrstück. Bei der Dünnschlauch-Lösung sitzt der Hörer im Hörgeräte-Gehäuse hinter dem Ohr. In der Übersicht auf Seite 4–5 können Sie nachsehen, welche Ohrstück-Lösung für Ihr Hörsystem gewählt wurde. Bitten Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker darum, dies anzukreuzen.

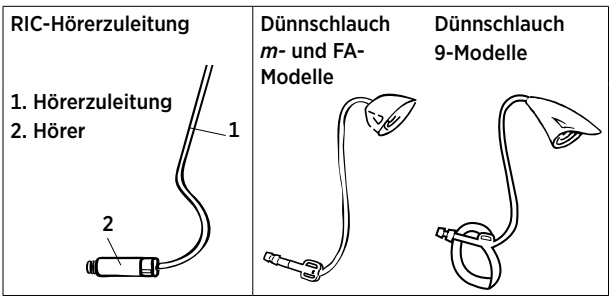

Hörer-Schirmchen

Hörer-Tulpe

Hörer-Doppeldome

Schirmchen

Tulpe

Doppeldome



Links/rechts-Kennung

Die Abbildung zeigt eine Hörerzuleitung. Hörerzuleitungen/Schläuche sind in verschiedenen Längen für das rechte bzw. linke Ohr erhältlich. Die Größe ist auf der Hörerzuleitung / dem Schlauch aufgedruckt (siehe Pfeil): rot = rechtes Ohr, blau = linkes Ohr.

Anlegen des Hörsystems

Die Abbildungen zeigen ein Schirmchen. Bei den anderen Standard-Ohrstücken ist die Vorgehensweise jedoch identisch.

Legen Sie das Hörgerät hinter das Ohr, so dass die Hörerzuleitung / der Schallschlauch dicht am Kopf auf dem Ohr liegt.

Halten Sie das Hörsystem am unteren Ende der Hörerzuleitung / des Schallschlauchs und platzieren Sie das Ohrstück im Gehörgang.

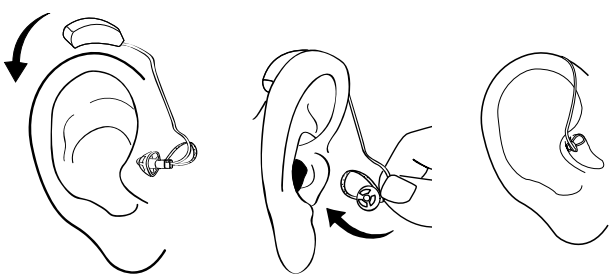

Wenn es sich bei Ihrem Ohrstück um eine **Tulpe** handelt, stellen Sie sicher, dass das größere Blatt über dem kleineren Blatt liegt und dieses überlappt.

Bei manchen Ohrstücken kann ein Ankerteil verwendet werden, um die Position des Ohrstücks zusätzlich zu sichern. Weitere Informationen über das Ankerteil finden Sie auf den Seiten 23-30.

Abnehmen des Hörsystems

Nehmen Sie das Hörgerät hinter dem Ohr ab.

Halten Sie die Hörerzuleitung / den Schallschlauch am unteren Ende fest und ziehen Sie das Ohrstück vorsichtig aus dem Gehörgang.

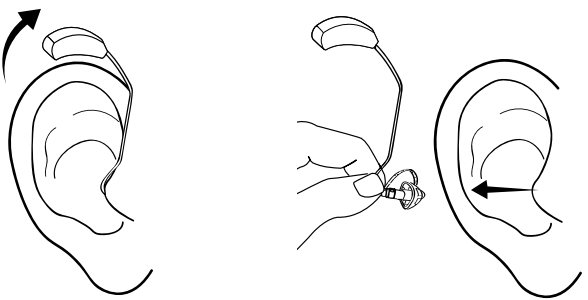

Pflege

Reinigungszubehör*:

1. Tuch
2. Langes Reinigungswerkzeug
3. Bürste
4. Reinigungsfaden

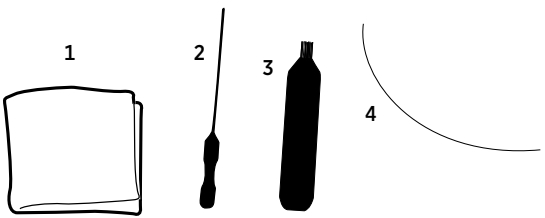

Zusätzliche Reinigungswerkzeuge sind bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker erhältlich.

** Abhängig von der gewählten Ohrstück-Lösung*

Standard-Ohrstück & RIC-Hörerzuleitung
(Hinweise zur Reinigung eines Standard-Ohrstücks mit Dünnschlauch finden Sie auf den Seiten 13 bis 15.)

Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Hörerzuleitung und das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen sind.

WARNUNG
Verwenden Sie zur Reinigung **auf keinen Fall** Alkohol oder andere Arten von Reinigungsmitteln, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.



Reinigen Sie die **Hörerzuleitung** nach jedem Tragen mit dem Tuch.

WARNUNG
Verwenden Sie zur Reinigung der Hörerzuleitung **auf keinen Fall** Wasser oder Reinigungsmittel.
Der Hörer (Lautsprecher) darf **unter keinen Umständen** mit Wasser in Berührung kommen, da dies den Hörer beschädigen kann.

Falls sich am Hörergehäuse Schmutz angesammelt hat, nehmen Sie das Ohrstück ab und reinigen Sie den Hörer mit dem Tuch.

Alle Standard-Ohrstücke: Falls notwendig, können Sie das Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Trennen Sie das Ohrstück dazu zunächst vom Hörer**. Spülen Sie das Ohrstück gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.

Bei RIC-Hörsystemen, bei denen der Hörer (Lautsprecher) am Ende der Hörerzuleitung im Ohrstück sitzt, muss ein Cerumenschutz verwendet werden (siehe Seite 19-22).

Standard-Ohrstück & Dünnschlauch

Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Schallschlauch und das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen sind.

WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung **auf keinen Fall** Alkohol oder andere Arten von Reinigungsmitteln, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.



***m*- und FA-Modelle**

Halten Sie das Hörgerät zwischen Daumen und Zeigefinger. Fassen Sie mit der anderen Hand den **Schallschlauch** und ziehen Sie den Schallschlauch mit dem Winkeladapter wie dargestellt in Pfeilrichtung ab. Hierfür gibt es auch ein kleines Werkzeug, das bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker erhältlich ist.



Ziehen Sie das Ohrstück vom Schallschlauch ab. Bei dem in den Abbildungen gezeigten Ohrstück handelt es sich um ein Schirmchen.



Führen Sie den Reinigungsfaden durch den Schallschlauch und ziehen Sie ihn am anderen Ende wieder heraus.

Falls notwendig, können Sie das Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Trennen Sie das Ohrstück dazu zunächst vom Schallschlauch.** Spülen Sie das Ohrstück gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.



9-Modelle

Heben Sie den Schallschlauch mit dem Winkeladapter vorsichtig mit einer schrägen Bewegung nach hinten ab (siehe Abb.).



Ziehen Sie das Ohrstück vom **Schallschlauch** ab. Bei dem in den Abbildungen gezeigten Ohrstück handelt es sich um ein Schirmchen.

Führen Sie den Reinigungsfaden durch den Schallschlauch und ziehen Sie ihn am anderen Ende wieder heraus.

Falls notwendig, können Sie das Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Trennen Sie das Ohrstück dazu zunächst vom Schallschlauch.** Spülen Sie das Ohrstück gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.

AUSWECHSELN DES SCHALLSCHLAUCHS / DER HÖRERZULEITUNG UND DES OHRSTÜCKS

Die Hörerzuleitung/der Schallschlauch und das Ohrstück müssen bei Bedarf gewechselt werden. Der Zeitraum, nach welchem sie ausgewechselt werden sollten, ist individuell unterschiedlich. Sollten Sie Veränderungen an Ihrem Hörsystem bemerken, suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Wenn Sie neue Hörerzuleitungen/Schallschläuche oder Ohrstücke benötigen oder die Größe des Ohrstücks nicht länger richtig passt, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

Montage des neuen bzw. gereinigten und getrockneten Ohrstücks

Drücken Sie den Schallschlauch bzw. den Hörer am Ende der Hörerzuleitung vorsichtig bis ans Ende ins Ohrstück. Dabei ist es sehr wichtig, dass das Schirmchen gut befestigt ist.

(Hörer-)Schirmchen, (Hörer-)Tulpe, (Hörer-)Doppeldome:

BITTE BEACHTEN:
Beim Hineindrücken eines Hörers ins Ohrstück spüren Sie, wie der Hörer einrastet.

Verschluss der Belüftungsöffnung (RIC-Lösung)
Der **Hörer-Doppeldome** ist mit einer Belüftungsöffnung (Vent) ausgestattet. Wurde eine geschlossene Lösung gewählt, wird die Belüftungsöffnung mit einem Venteinsatz verschlossen.

Wenn Sie den Hörer-Doppeldome wechseln, müssen Sie daher auch einen neuen Venteinsatz einsetzen.

Drücken Sie die komplette Spitze des Venteinsatz-Stäbchens von innen in die Belüftungsöffnung (siehe Abb.) und brechen Sie dann die Spitze (= Venteinsatz) ab. Vergewissern Sie sich, dass der Venteinsatz sicher in der Belüftungsöffnung sitzt.

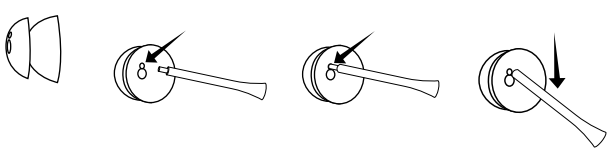

NANOCARE CERUMENSCHUTZ

Bei RIC-Hörsystemen, bei denen der Hörer (Lautsprecher) am Ende der Hörerzuleitung im Ohrstück sitzt, muss ein NanoCare Cerumenschutz verwendet werden.

Der NanoCare Cerumenschutz ist ein Filter, der dabei hilft, den Hörer (Lautsprecher) vor Ohrenschmalz (Cerumen) zu schützen. Tragen Sie Ihr RIC-Hörsystem niemals ohne den NanoCare Cerumenschutz.

Das Cerumenschutz-Set besteht aus folgenden Teilen:

1. **Haltestäbchen**
2. **Ziehhaken**
3. **Cerumenschutz**

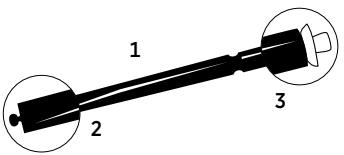

VORSICHT

Ein Cerumenschutz ist nur für die einmalige Verwendung vorgesehen. Versuchen Sie **nicht**, einen gebrauchten Cerumenschutz zu reinigen oder wiederzuverwenden. Dies könnte das Hörsystem beschädigen oder dazu führen, dass sich der Cerumenschutz vom Hörsystem löst.

Wechsel des Cerumenschutzes

1. Stecken Sie den kleinen Ziehhaken des Haltestäbchens in den am Schallauslass angebrachten Cerumenschutz ein.
2. Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz heraus.







Drehen Sie das Haltestäbchen um.

3. Setzen Sie den neuen Cerumenschutz am Schallauslass an und drücken Sie ihn vorsichtig auf den Hörer.
4. Ziehen Sie das Haltestäbchen heraus. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Haltestäbchen. Stellen Sie sicher, dass der Cerumenschutz sicher sitzt.

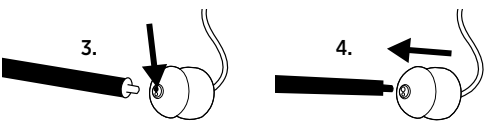



Werfen Sie das Haltestäbchen mit dem alten Cerumenschutz weg.

Wie oft der Cerumenschutz gewechselt werden muss, ist individuell.

Haben Sie Fragen zum Gebrauch des Cerumenschutzes, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

WARNUNG

Falls der Cerumenschutz nicht richtig im Schallauslass sitzt, muss der Cerumenschutz entfernt und ein neuer eingesetzt werden. Sollte sich der Cerumenschutz einmal versehentlich vom Ohrstück lösen und im Gehörgang bleiben, gehen Sie bitte sofort zu Ihrem HNO-Arzt. Versuchen Sie niemals selbst, den Cerumenschutz aus dem Gehörgang zu entfernen.

LOSES ANKERTEIL

VORSICHT

Um den korrekten Sitz des Hörsystems mit **Hörer-Schirmchen** oder **Hörer-Tulpe** zu sichern, empfehlen wir die Verwendung des Ankerteils. Für den **Hörer-Doppeldome** wird kein Ankerteil verwendet.

Das Ankerteil wird separat geliefert und kann unterschiedlich genutzt werden. Das Ankerteil kann mit oder ohne vorheriges Zuschneiden benutzt werden. Hier sehen Sie zuerst die Benutzung ohne Zuschneiden:

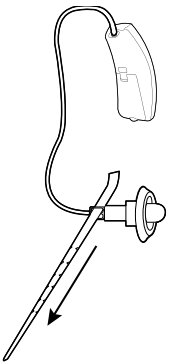

Die Abbildungen zeigen ein Hörsystem mit einem Hörer-Schirmchen; bei einer Hörer-Tulpe ist die Vorgehensweise jedoch identisch.

Ziehen Sie das spitze Ende des Ankerteils durch die obere Öffnung am Hörer, der am Ende der Hörerzuleitung angebracht ist. Der abgewinkelte Widerhaken am anderen Ende des Ankerteils sollte zum Hörgerät zeigen.

Ziehen Sie das Ankerteil durch die Öffnung, bis der Widerhaken am Ende anschlägt.

Nun kann das an der Hörerzuleitung angebrachte Ohrstück so positioniert werden, dass es angenehm im Ohr sitzt und das Ankerteil den Sitz sichert.

Die Benutzung des Ankerteils mit Zuschneiden erfolgt auf diese Weise:



Ziehen Sie das spitze Ende des Ankerteils durch die obere Öffnung am Hörer, der am Ende der Hörerzuleitung angebracht ist. Der abgewinkelte Widerhaken am anderen Ende des Ankerteils sollte zum Hörgerät zeigen.

Ziehen Sie das Ankerteil durch die Öffnung, bis der Widerhaken am Ende anschlägt. Drehen Sie Hörerzuleitung und Ohrstück um, sodass Sie von der anderen Seite auf den Hörer sehen.



Führen Sie das spitze Ende nun durch die untere Öffnung, sodass eine Schlaufe gebildet wird.



Wenn die Schlaufe die richtige Größe hat, schneiden Sie überstehendes Material ab, sodass nur noch die Schlaufe zu sehen ist.

Die Schlaufe hat die richtige Größe, wenn sie die Position des Ohrstücks im Gehörgang sichert und dadurch auch der Hörer und die Hörerzuleitung einen guten Sitz im und am Ohr haben.



Achten Sie dabei sorgfältig darauf, das gesamte überschüssige Material abzuschneiden, sodass das Ende der Ankerschlaufe bündig mit der kleinen Öffnung abschließt und keine scharfen Kanten hinterlässt. Prüfen Sie Letzteres mit der Fingerspitze. Wenn ein Teil des Ankerteils aus der Öffnung herausragt und eine unebene Oberfläche bildet, kann dies Reizungen am Ohr verursachen.

INTEGRIERTES ANKERTEIL

Für den **Doppeldome** wird kein Ankerteil verwendet; dieses sollte komplett abgeschnitten werden.

Für das **Schirmchen** und die **Tulpe** kann das Ankerteil ohne vorheriges Zuschneiden verwendet werden.

Wenn das Ankerteil zugeschnitten wird, muss es zu einer passenden Ankerschlaufe geformt werden. Nur so ist eine komfortable Position des Ohrstücks im Gehörgang gewährleistet. Es gibt zwei Möglichkeiten:

Die Abbildungen zeigen ein Schirmchen, bei einer Tulpe ist die Vorgehensweise jedoch identisch.

Beispiel 1

Ziehen Sie die Spitze des Ankerteils durch die kleine Öffnung an der Seite des Schallschlauchs.

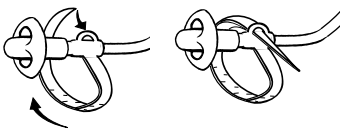

Wenn die Schlaufe die richtige Größe hat, schneiden Sie überstehendes Material mit einer Schere o. Ä. ab.

Die Schlaufe hat die richtige Größe, wenn sie die Position des Ohrstücks im Gehörgang sichert und dadurch auch der Schlauch einen guten Sitz am Ohr hat.



Beispiel 2

Legen Sie das Ankerteil in eine Schlaufe wie durch die gepunktete Linie und die Pfeile angezeigt.



Führen Sie die Spitze des Ankerteils nun wie gezeigt durch die kleine Öffnung an der Seite des Schallschlauchs, sodass die Schlaufe geschlossen wird.



Wenn die Schlaufe die richtige Größe hat, drehen Sie Schlauch und Ohrstück herum und schneiden Sie überstehendes Material mit einer Schere o. Ä. ab.



Die Schlaufe hat die richtige Größe, wenn sie die Position des Ohrstücks im Gehörgang sichert und dadurch auch der Schlauch einen guten Sitz am Ohr hat.

Allgemeine Hinweise:

Achten Sie darauf, dass das Ende der Ankerschlaufe bündig mit der kleinen Öffnung abschließt und keine scharfen Kanten hinterlässt. Prüfen Sie Letzteres mit der Fingerspitze.



Wenn ein Teil des Ankerteils aus der Öffnung herausragt und eine unebene Oberfläche bildet, kann dies Reizungen am Ohr verursachen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Ohrstücke mit Hörerzuleitung

Hier finden Sie einige Tipps für den Fall, dass Ihr Hörsystem nicht korrekt funktioniert. Bitte beachten Sie außerdem die Tipps in der Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems. Besteht das jeweilige Problem weiterhin, suchen Sie bitte Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Das Hörsystem ist völlig stumm.

Der Cerumenschutz ist verstopft.
Wechseln Sie den Cerumenschutz.

Die Hörerzuleitung ist gerissen.
Suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Das Hörsystem ist zu leise.

Der Cerumenschutz ist verstopft.
Wechseln Sie den Cerumenschutz.

Das Hörsystem pfeift dauernd.

Das Ohrstück sitzt nicht richtig im Ohr.
Nehmen Sie das Ohrstück aus dem Ohr und setzen Sie es erneut ein. Besteht das Problem weiterhin, suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Das Ohrstück sitzt zu locker.
Suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Der Hörer (=Lautsprecher) sitzt nicht richtig im Ohrstück.
Wechseln Sie das Ohrstück. Besteht das Problem weiterhin, suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Ohrstücke mit Schallschlauch

Hier finden Sie einige Tipps für den Fall, dass Ihr Hörsystem nicht korrekt funktioniert. Bitte beachten Sie außerdem die Tipps in der Bedienungsanleitung Ihres Hörsystems. Besteht das jeweilige Problem weiterhin, suchen Sie bitte Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Das Hörsystem ist zu leise oder völlig stumm.

Der Schallauslass ist verstopft.
Reinigen oder wechseln Sie das Ohrstück.

Reinigen oder wechseln Sie den Schlauch.

Das Hörsystem pfeift dauernd.

Der Schallschlauch ist gelblich, unflexibel oder undicht.
Wechseln Sie den Schlauch.

Das Ohrstück sitzt nicht richtig im Ohr.
Nehmen Sie das Ohrstück aus dem Ohr und setzen Sie es erneut ein. Besteht das Problem weiterhin, suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Das Ohrstück sitzt zu locker.
Suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

WARNHINWEISE

WARNUNG

- Das Hörsystem ist aus modernem hautverträglichem Kunststoffmaterial hergestellt; allergische Reaktionen kommen deshalb so gut wie nie vor. Sollten Hautirritationen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker. Dieser wird ein solches Problem meistens lösen können.
- Mit dem Tragen von allen Arten von Hörsystemen ist eine erhöhte Gefahr von Infektionen im Gehörgang verbunden. Eine Infektion kann entstehen, wenn das Ohr nicht ausreichend belüftet wird. Wir empfehlen deshalb, das Hörsystem nachts herauszunehmen, damit Ihr Gehörgang belüftet wird. Darüber hinaus müssen Sie Ihr Hörsystem nach Bedarf reinigen und überprüfen. Im Falle einer Infektion wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt. Wie Sie Ihr Hörsystem am besten desinfizieren, können Sie mit Ihrem Hörgeräte-Akustiker besprechen. Zum Reinigen und Desinfizieren darf unter keinen Umständen Alkohol, Chlor o. Ä. verwendet werden.

AUFBEWAHRUNG UND ALLGEMEINE HANDHABUNG

Ihr Hörsystem ist ein hochwertiges elektronisches Produkt; behandeln Sie es daher stets sorgfältig. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um die Lebensdauer Ihres Hörsystems zu verlängern:

VORSICHT

- Schalten Sie das Hörsystem aus, wenn Sie es ablegen. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
- Während Sie das Hörsystem nicht tragen, bewahren Sie es im Etui, an einem trockenen Ort und für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
- Setzen Sie das Hörsystem nicht zu großer Hitze oder der prallen Sonne aus, und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Lassen Sie das Hörsystem nach schweißtreibenden Aktivitäten wie z. B. Sport gut auslüften.
- Lassen Sie Ihr Hörsystem nicht fallen. Nehmen Sie die Reinigung und den Batteriewechsel über einer weichen Unterlage vor, damit das Hörsystem keinen Schaden erleidet, wenn es Ihnen aus der Hand gleiten sollte.
- Legen Sie das Hörsystem zum Baden, Duschen oder Haarewaschen und -trocknen ab. Bringen Sie es nicht mit Parfüm, Haar- und Körperpflegeprodukten in Berührung.
- Wer in feuchten Klimazonen lebt oder zum Schwitzen neigt, sollte regelmäßig spezielle Trocknungssysteme verwenden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Packungsbeilage des Trocken-Kits, welches beim Hörgeräte-Akustiker erhältlich ist.

Werfen Sie Hörgeräte, Zubehör und Batterien nicht in den Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur fachgerechten Entsorgung zu Ihrem Hörgeräte-Akustiker oder direkt zu einer kommunalen Sammelstelle für elektronische Altgeräte.

Vertrieb in Deutschland durch:

Widex Hörgeräte GmbH
Postfach 80 01 26
70501 Stuttgart

www.widex-hoergeraete.de

CE 0459

Hersteller
WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Denmark • www.widex.com

Printed by HTO / 2013-05
9 514 0249 042 #01